



VEDISE Hospital

Improving Life

ORL
linea aspirazione

MEDI PLAST®



Sommario

ASPIRATORI IN METALLO	2
MANICI PER LA REGOLAZIONE DELL'ASPIRAZIONE	3
MEDIBENDER	4
SPECULI AURICOLARI	5
BISTURI PER MIRINGOTOMIA	6
KIT PER MIRINGOTOMIA	7
KIT PER LA CHIRURGIA DELL'ORECCHIO MEDIO	8
ASPIRATORE NASALE	9
ASPIRATORI NASALI CON MANICO TRASPARENTE	10
ASPIRATORI NASALI TIPO FERG	11
ASPIRATORI NASALI TIPO FERG CON FORO LATERALE	12
ASPIRATORI ENDONASALI CON MANICO TRASPARENTE	13
ASPIRATORI PER OTONEUROCHIRURGIA	14
SPECULI NASALI	15
ASPIRATORI IN PLASTICA	16
ASPIRATORE PER BRONCOSCOPIA	17
ASPIRATORE PER BRONCO-ESOFAGOSCOPIA	18
TUBI PER ASPIRAZIONE	19
APPLICATORI	20
SET IRRIGAZIONE ANTRO	21
PUNTA PER IRRIGAZIONE AURICOLARE IN SICUREZZA	22
SJECT SIRINGA PER LAVAGGIO AURICOLARE	23

ASPIRATORI IN METALLO



- Monouso, per chirurgia ed esami ORL
- Sterili, in confezione singola con apertura a strappo
- Sterilizzati con ETO
- L'angolo di curvatura è studiato appositamente per esami microscopici e per la chirurgia
- Connettore rapido – semplifica la sostituzione durante gli interventi chirurgici

<i>Art.no.</i>	<i>misure mm</i>	<i>ward.box/trsp.box</i>	
6066500040	0,4x70	lilla	60/900
6066507040	0,4/0,7x77	lilla	10/140
6066500070	0,7x70	nero	60/900
6066500100	1,0x70	marrone	60/900
6066500140	1,4x70	bianco	60/900
6066500208	2,0x70	verde	60/900
6066500045	0,4x80	lilla	60/900
6066500072	0,7x80	nero	60/900
6066500102	1,0x80	marrone	60/900
6066500142	1,4x80	bianco	60/900
6066500200	2,0x80	verde	60/900
6066500250	2,5x80	arancione	30/900
6066500300	3,0x80	blu	30/900
6066500400	4,0x80	giallo	30/900
6066509100	1,0x100	marrone	30/900
6066509140	1,4x100	bianco	30/900
6066509200	2,0x100	verde	30/900
6066509250	2,5x100	arancione	30/900
6066509300	3,0x100	blu	30/900

Novità! Aspiratore per staffa


- Doppio tubo per una maggiore resistenza + terminale con lume fine
- Per procedure di stapedotomia e stapedectomy



Materiale: PPI Acciaio inossidabile di grado medicale (virgin steel)
MDD Rule: Rule 6
MDD Class: IIa
CE: Conforme alla normativa *vigente*

ward.box = ordine minimo

MANICI PER LA REGOLAZIONE DELL'ASPIRAZIONE

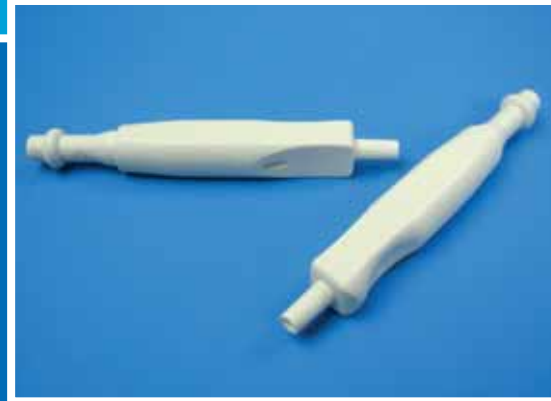

- Manici per aspirazione, con o senza regolazione dell'aspirazione, possono connettere gli aspiratori con i tubi per aspirazione Mediplast
- Monouso, sterili, in confezione singola con apertura a strappo
- Plastica ABS bianca

<i>Art.no.</i>		<i>ward.box./trsp.box</i>
6066500992	con controllo	75/1125
6066505009	senza controllo	75/1125
6066500990	con controllo	25/25

Materiale: ABS
MDD Rule: Rule 1
MDD Class: I sterile
CE: Conforme alla normativa vigente

ward.box = ordine minimo

MEDIBENDER

Piegatrice manuale per gli aspiratori monouso in metallo: diametro da 2,0 mm - 1,4 mm - 1,0 mm



- In acciaio inossidabile
- Non sterile
- Autoclavabile

Istruzioni:

1. Afferrare lo strumento con il pollice in corrispondenza dell'incisione "Mediplast", lasciando i fori visibili sull'estremità superiore.
2. Prendere l'aspiratore in metallo della misura desiderata
3. Inserire l'aspiratore all'interno del foro del diametro appropriato:
foro di sinistra = 2,0 mm
foro centrale = 1,4 mm
foro di destra = 1,0 mm
4. Piegare l'aspiratore delicatamente.

Materiale: Acciaio inossidabile
MDD Rule: Rule 1
MDD Class: I non-sterile
CE: Conforme alla normativa vigente

Art.no. ward.box./trsp.box
6066500 1/1

SPECULI AURICOLARI



- Nuovo disegno ovale del cono, terminale con taglio obliquo per una maggiore visuale
- Anello più ampio per una presa migliore
- Per diagnostica
- Igienizzati
- Non contengono latex né PVC

<i>Art.no.</i>	<i>mm</i>	<i>ward.box/trsp.box</i>
606625	2,5	100/2800
606640	4	100/2800
606650	5	100/2800
606660	6	100/2800
606670	7	100/2800
606680	8	100/2800

Materiale: PP
MDD Rule: Rule 5 - 1
MDD Class: I
CE: Conforme alla normativa vigente

ward.box = ordine minimo

BISTURI PER MIRINGOTOMIA



- Bisturi monouso per miringotomia, punta con triplo taglio
- Utilizzabile per paracentesi
- Sterile, confezione singola con apertura a strappo

Materiale: PPI Acciaio inox di grado
medicale (virgin steel)
MDD Rule: Rule 6
MDD Class: IIa
CE: Conforme alla normativa vigente

<i>Art.no.</i>	<i>mm</i>	<i>ward.box/trsp.box</i>
6066121370	1,3x70	30/450

ward.box = ordine minimo

KIT PER MIRINGOTOMIA



- Kit pronto all'uso per paracentesi
- Monouso
- Sterile, confezione singola con apertura a strappo

Art.no. ward.box./trsp.box
6066143300 30/180

Contenuto: Aspiratori in metallo
1,4x70 mm
2,0x70 mm
2,5x80 mm
Bisturi per miringotomia
Manico controllo aspirazione
Speculi auricolari
(2,5 mm, 4 mm, 5 mm)
2 Garze non-woven
Campo sterile

6066143400 30/180

Contenuto: Aspiratori in metallo
1,4x70 mm
2,0x70 mm
4,0x80 mm
Bisturi per miringotomia
Manico controllo aspirazione
Speculi auricolari
(5 mm, 6 mm, 7 mm)
2 Garze non-woven
Campo sterile

Materiale: PP/ ABS/ Acciaio inossidabile
di grado medicale (virgin steel)
MDD Rule: Rule 6
MDD Class: IIa
CE: Conforme alla normativa vigente

ward.box = ordine minimo

KIT PER LA CHIRURGIA DELL'ORECCHIO MEDIO



- Kit pronto per la chirurgia dell'orecchio medio
- Monouso, sterile, confezione singola con apertura a strappo

Art.no. ward.box/trsp.box
6066502070 30/30

Contenuto: Aspiratori in metallo
1,0x70 mm (2 pz)
1,4x70 mm (2 pz)
2,0x80 mm (2 pz)
Manico controllo aspirazione
Tubo aspirazione Mediplast di 2 m

6066532070 30/30

Contenuto: Aspiratori in metallo
1,0x70 mm (2 pcs)
1,4x70 mm (2 pcs)
2,0x80 mm (2 pcs)
Manico controllo aspirazione
Tubo aspirazione Mediplast di 3,5 m

Materiale: PP/ PVC/ Acciaio inossidabile
di grado medicale (virgin steel)
MDD Rule: Rule 6
MDD Class: IIa
CE: Conforme alla normativa vigente

ward.box = ordine minimo

ASPIRATORE NASALE



- Per interventi chirurgici ed esami rinologici
- Monouso, sterile, confezione singola con apertura a strappo
- In acciaio inossidabile di grado medicale, manico luer slip (PP)

<i>Art.no.</i>	<i>mm</i>	<i>ward.box./trsp.box</i>	
6066516020	2,0x150	verde	40/600
6066516030	3,0x150	blu	40/600
6066516040	4,0x150	giallo	40/600

ward.box = ordine minimo

Materiale: PP/ Acciaio inossidabile di grado medicale (virgin steel)
MDD Rule: Rule 6
MDD Class: IIa
CE: Conforme alla normativa vigente

ASPIRATORI NASALI CON MANICO TRASPARENTE



- Per interventi chirurgici ed esami rinologici
- Monouso, sterile, confezione singola con apertura a strappo
- In acciaio inossidabile di grado medicale, manico trasparente in PMMA

<i>Art.no.</i>	<i>mm</i>	<i>ward.box./trsp.box</i>
6066516120	2,0x150	25/375
6066516130	3,0x150	25/375
6066516140	4,0x150	25/375

ward.box = ordine minimo

Materiale: PMMA/ Acciaio inossidabile di grado medicale (virgin steel)
MDD Rule: Rule 6
MDD Class: IIa
CE: Conforme alla normativa vigente

ASPIRATORI NASALI TIPO FERG CON FORO LATERALE



- Per interventi rinologici delicati
- Dotato di foro laterale per prevenire gli effetti della biopsia (danneggiamento del tessuto)
- Monouso, sterile, confezione con apertura a strappo
- Acciaio inossidabile di grado medicale, manico trasparente in PMMA, con controllo aspirazione integrato

<i>Art.no.</i>	<i>mm</i>	<i>ward.box/trsp.box</i>
6066511020	2,0x150	25/375
6066511030	3,0x150	25/375
6066511040	4,0x150	25/375

Materiale: PMMA/ Acciaio inossidabile di grado medicale ("virgin steel")
MDD Rule: Rule 6
MDD Class: IIa
CE: Conforme alla normativa vigente

ward.box = ordine minimo

ASPIRATORI ENDONASALI CON MANICO TRASPARENTE



- Per la chirurgia rinologica, interventi FESS
- Terminale ad oliva atraumatico
- Monouso, sterile, confezione singola con apertura a strappo
- Acciaio inossidabile di grado medicale, manico trasparente in PMMA

<i>Art.no.</i>	<i>mm</i>	<i>ward.box/trsp.box</i>
6066503020	2,0x150	25/375
6066503025	2,5x150	25/375
6066503030	3,0x150	25/375
6066503035	3,5x150	25/375
6066503040	4,0x150	25/375

Materiale: PMMA/ Acciaio inossidabile di grado medicale (virgin steel)
MDD Rule: Rule 6
MDD Class: IIa
CE: Conforme alla normativa vigente

ward.box = ordine minimo

ASPIRATORI PER OTONEUROCHIRURGIA



- Per procedure delicate di otoneurochirurgia
- Dotato di due fori laterali sul terminale per evitare effetti della biopsia (danneggiamento del tessuto)
- Monouso, sterile, confezione con apertura a strappo
- Acciaio inox di grado medicale, manico trasparente (PMMA) con controllo aspirazione integrato

<i>Art.no.</i>	<i>mm</i>	<i>ward.box./trsp.box</i>
6066509020	2,0x110	25/375
6066509025	2,5x110	25/375
6066509030	3,0x110	25/375
6066509035	3,5x110	25/375

ward.box = ordine minimo

Materiale: PP
MDD Rule: Rule 2
MDD Class: IIa

SPECULI NASALI




- Monouso, igienizzati e confezionati singolarmente
- In plastica bianca ABS, molla in acciaio inox
- Il meccanismo a molla inverso consente al medico di avere libere entrambe le mani

Materiale: ABS / Acciaio inossidabile
MDD Rule: Rule 5, subrule 1
MDD Class: I non sterile
CE: Conforme alla normativa vigente

Art.no. ward.box./trsp.box
6066516100 20/200
ward.box = ordine minimo

ASPIRATORI IN PLASTICA

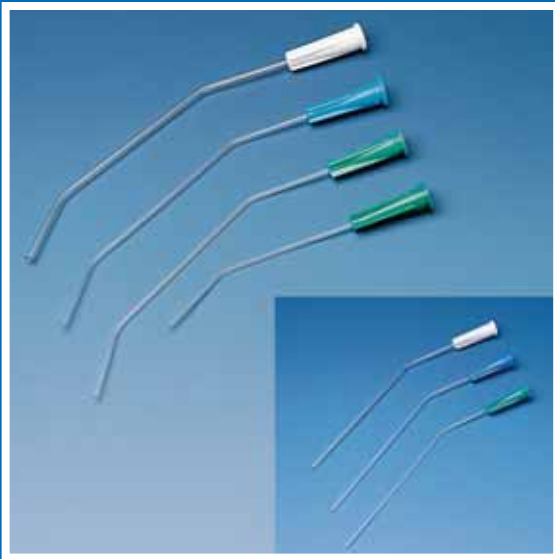

- Aspiratori in plastica con punta arrotondata, smussata
- Perfettamente adattabili agli Oto-set Mediplast con controllo dell'aspirazione
- Disponibili con curvatura singola o doppia
- Sterili, confezione singola con apertura a strappo

<i>Art.no.</i>	<i>mm</i>	<i>colore</i>	<i>ward.box/trsp.box</i>
<i>Curvatura doppia</i>			
6066101627	2,0x150	verde	40/600
6066101635	3,0x150	blu	40/600
6066101643	4,0x150	bianco	40/600
<i>Corto</i>			
6066101023	2,0x100	verde	40/600
<i>Curvatura singola</i>			
6066100627	2,0x150	verde	40/600
6066100635	3,0x150	blu	40/600
6066100643	4,0x150	bianco	40/600

ward.box = ordine minimo

Materiale: PVC/PP
MDD Rule: Rule 5
MDD Class: I sterile
CE: Conforme alla normativa vigente

ASPIRATORE PER BRONCOSCOPIA



- Aspiratore per broncoscopia pediatrica
- Monouso
- Sterile, confezione singola con apertura a strappo

Materiale: PPI Acciaio inossidabile di grado medicale (virgin steel)
MDD Rule: Rule 6
MDD Class: IIa
CE: Conforme alla normativa vigente

<i>Art.no.</i>	<i>mm</i>	<i>colore</i>	<i>ward.box/trsp.box</i>
6061626280	2,0x300	verde	10

ward.box = ordine minimo

ASPIRATORI PER BRONCO-ESOFAGOSCOPIA



- Aspiratori per adulti e pediatrici per broncoscopia ed esofagoscopia
- Per ottiche rette/rigide
- Monouso, di diverse lunghezze e diametri
- Nuovo manico trasparente per un controllo migliore
- Sterile, confezione singola con apertura a strappo
- Sterilizzato con ETO

<i>Art.no.</i>	<i>misure mm</i>	<i>ward.box/trsp.box</i>
6061616242	2,0x400	10/90
6061616243	3,0x400	10/90
6061616244	4,0x400	10/90
6061616232	2,0x300	10/90
6061616233	3,0x300	10/90
6061616234	4,0x300	10/90
6061616252	2,0x500	10/90
6061616253	3,0x500	10/90
6061616254	4,0x500	10/90
6061616262	2,0x550	10/90
6061616263	3,0x550	10/90
6061616264	4,0x550	10/90

Materiale: PMMA/ Acciaio inossidabile di grado medicale (virgin steel)
MDD Rule: Rule 6
MDD Class: IIa
CE: Conforme alla normativa vigente

ward.box = ordine minimo

TUBI PER ASPIRAZIONE




- Vasto assortimento di tubi in PVC e non
- Flessibili, resistenti alle piegature e alla pressione esercitata dall'aspiratore
- Disponibili in 3 diversi confezionamenti:
 - Tubi per aspirazione sterili – doppio confezionamento con apertura a strappo
 - Tubi per aspirazione igienizzati – in confezione con apertura a strappo
 - Tubi per aspirazione in rotolo – igienizzati e confezionati in rotolo

Art..no.	lunghezza	d.int. x d.est.	durezza shore	ch	sterile	pz/cf
6099990	200 cm	6x8	60-63	25	EO	50
6099992	350 cm					40
6099994	200 cm	6x8	60-63	25	EO	50
6099996	350 cm					40
6099987	200 cm	6x8	60-63	25	EO	50
6099998	200 cm	6x8	60-63	25	EO	50
6099999	350 cm					40

Tubi per aspirazione ORL lisci extra flessibili

Materiale: PVC e non PVC: XS119
MDD Rule: Rule 2
MDD Class: I, Is
CE: Conforme alla normativa vigente

SET IRRIGAZIONE ANTRO

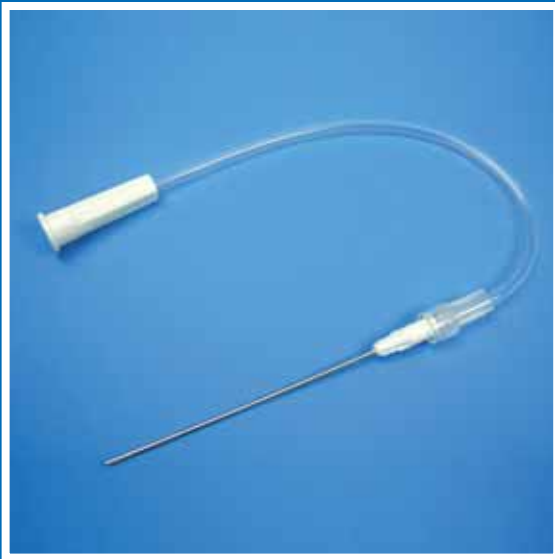

- Dotato di ago 1,4 x 80 mm e prolunga di 200 mm con connettore luer-lock
- Monouso, sterile, confezione singola con apertura a strappo

Materiale: PP/ PVC/ Acciaio inossidabile di grado medicale (virgin steel)
MDD Rule: Rule 6
MDD Class: IIa
CE: Conforme alla normativa vigente

Art.no.
6066140146

ward.box/trsp.box
10/300

ward.box = ordine minimo

PUNTA PER IRRIGAZIONE AURICOLARE IN SICUREZZA



- Adatta a siringhe con cono catetere, stop di sicurezza
- Non-sterile, confezione singola con apertura a strappo

Materiale: Plastica ABS
MDD Rule: Rule 1
MDD Class: I non-sterile
CE: Conforme alla normativa vigente

Art.no.
6061220000

ward.box/trsp.box
25/750

ward.box = ordine minimo

SJECT SIRINGA PER LAVAGGIO AURICOLARE



- Siringa multiuso da 100 ml
- Sterile, confezione singola con apertura a strappo

Materiale: PP
MDD Rule: Rule 1
MDD Class: I sterile
CE: Conforme alla normativa vigente

Art.no.
6061990011

ward.box./trsp.box
20/40


ward.box = ordine minimo

MEDIPLAST®

ASPIRATORI IN METALLO


Costruiti in acciaio
inossidabile
medical grade
(virgin steel)

Angolo degli aspiratori
specificamente studiato
per favorire gli esami
e la chirurgia
con microscopio

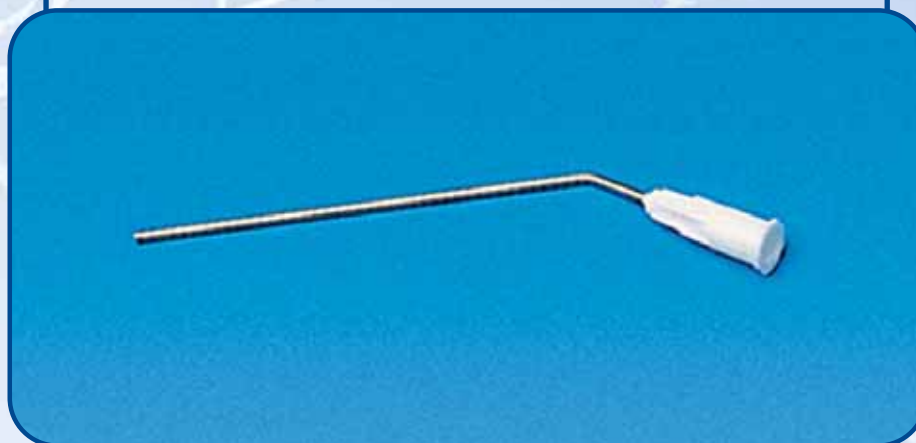

Atraumatico per il paziente
Punta levigata ed arrotondata

Attacco Luer-Lock
in polipropilene
con codice colore,
adattabile a tutte
le componenti standard
Luer-Lock e Luer Slip

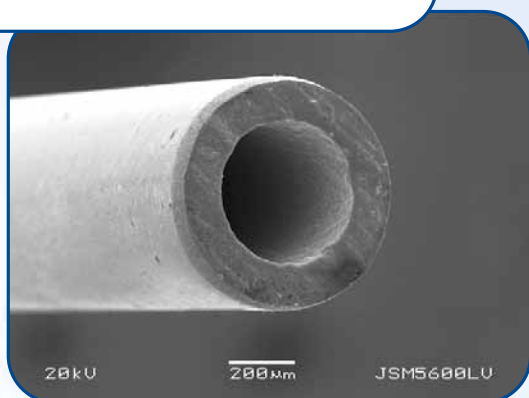

MEDIPLAST®





VEDISE Hospital

Improving Life

VE.DI.SE. Hospital S.p.A.

VENDITA DISTRIBUZIONE SERVIZI OSPEDALIERI IMPORT-EXPORT

Via Portuense, 949/a | 00148 Roma | Tel. +39.06.65671922 r.a.
Fax +39.06.65670255 | info@vedise.it | www.vedise.it